IQ-Well Scan

Quanten Resonanz Magnet Analysator

Zeigt den körperlichen und energetischen Zustand an

IQ-Well® SCAN

Quanten Resonanz Magnet Analysator

Inhalt

Vorwort 2
Beschreibung des Prinzips 3
Was ist der Quantum Resonanz Magnet Analysator 3

Software Installationsanleitung 4
Installationsvorgang 4
Wichtiger Hinweis 5

Software Anleitungen. 6
Hauptmenu 6
Kundenverwaltung 7-8
Test starten 9
Bericht erzeugen 10-11
Verwaltung der Expertentipps 12
Kopf- und Fußzeile des Berichts**.** 12
Datenbank sichern und wiederherstellen 13
System Setup**.** 13
Hilfe 14

Vorgehensweise für die Prüfung 14
Prüfverfahren 14
Arbeitsbedingungen im Testraum 15
Wichtiger Hinweis für die getestete Person 16
Aufgaben der testenden Person**.** 16
Wartungsmethoden für den Operator 17

Service und Wartung 18

Statement 18

Reklamationsschein 19

Vorwort

Beschreibung des Prinzips

Der menschliche Körper ist ein Zusammenschluss einer großen Anzahl von Zellen, die in kontinuierlichem Wachstum, Entwicklung, Differenzierung, Regeneration und Apoptose (programmierter Zelltod) sind. Diese Zellen erneuern sich ständig durch ihre eigene Teilung. 25 Millionen Zellen werden im Körper eines Erwachsenen in einer Sekunde geteilt und die Blutzellen des Körpers erneuern sich ständig mit einer Rate von etwa 100 Millionen pro Minute.
Im Prozess von Zellteilung und Wachstum bilden jene geladenen Körper von Atomkernen neue Atome als Grundeinheit von Zellen und die Elektronen außerhalb der Kerne befinden sich in fortwährender Hochgeschwindigkeits-Bewegung und ~Wechsel während sie dabei ständig elektromagnetische Wellen aussenden.
Die vom menschlichen Körper ausgesandten elektromagnetischen Wellensignale stellen den typischen Zustand des menschlichen Körpers dar. Die emittierten elektromagnetischen Wellensignale sind unter den verschiedenartigen Zuständen des menschlichen Körpers - wie z.B. Krankheit, Ernährung usw. - unterschiedlich.
Wenn wir diese spezifischen elektromagnetischen Wellensignale bestimmen können, sind wir in der Lage, den Status des lebendigen Körpers bestimmen.
Die Quantenmedizin ist der Auffassung, dass der wesentliche Grund für das Krankwerden darin besteht, dass sich der Spin der Elektronen außerhalb des Atomkerns und des Orbits ändert, wodurch eine Änderung bei Atomen verursacht wird, die Material bildend wirken, weiter eine Veränderung bei kleinen Biomolekülen, weiter eine Veränderung bei großen Biomolekülen bis hin zur Veränderung von Zellen und schlussendlich ganzer Organe.
Da das Elektron ein geladenes Teilchen ist, ändert sich die elektromagnetische Welle, die von den Atomen emittiert wird, wenn sich der Spin der Elektronen außerhalb des Atomkerns und des Orbits ändert. Die Energie der durch die Veränderungen der Krankheiten des menschlichen Körpers und der physischen Veränderungen des Ernährungszustandes verursachten Veränderungen der elektromagnetischen Wellen ist extrem schwach und beträgt gewöhnlich nur Nano-bis Mikrogauß.
Die Frequenzen und die Energie des schwachen Magnetfeldes, die direkt durch das Halten eines Sensors von Hand bestimmt sind inklusive der Messergebnisse der beiden Elektroden an den Schläfen, werden verglichen mit den Resonanzspektren des Standardquantums von Dysbalancen und Nährstoffindikatoren, die im Instrument voreingestellt sind. Danach wird die

Frequenz und Energie durch das Instrument verstärkt und vom Computer verarbeitet und der entsprechende Quantenwert, der von negativ bis positiv sein kann, wird ausgegeben.
Die Größe des Quantenwertes gibt Auskunft über Art und Ausmaß des körperlichen Funktionszustandes und die Ernährungswerte. Schließlich werden die Testergebnisse erklärt. Zum Beispiel unterscheiden sich kranke von normalen Zellen und die von kranken Zellen emittierten elektromagnetischen Wellen unterscheiden sich auch von den elektromagnetischen Wellen, die von normalen Zellen emittiert werden.
Ein Quantum-Resonanz-Test auf negativen Wert sendet eine Standard Welle von veränderten Zellen zum Prüfling. Wenn es veränderte Zellen im menschlichen Körper gibt, wird eine Resonanz auftreten und das IQ-Well® Gerät wird das Signal erkennen. Je größer die Anzahl der veränderten Zellen ist, desto intensiver ist das Signal und der Quantenwert tendiert zum negativen Wert. Wenn keine veränderten Zellen vorhanden sind, tritt keine Resonanz auf und der Quantenwert tendiert zum positiven Wert.
Es ist im Prinzip ähnlich wie beim Hören von Rundfunksendungen aus dem Radio. Es gibt viele Radiowellen im Äther. Wenn Sie eine bestimmte Sendung hören möchten, können Sie das Radio auf die entsprechende Frequenz einstellen. In diesem Moment tritt Resonanz auf, so dass Sie diese Sendung hören können. Die Quanten Resonanz verwendet genau dieses Prinzip zum Testen.

Was ist der IQ Well® Quanten Resonanz Magnet Analysator

Der IQ-Well® Quanten Resonanz Magnet Analysator ist das Ergebnis von High-Tech-Innovationsprojekten aus Medizin, Bioinformatik, Elektrotechnik und anderen Wissenschaften. Unter Verwendung der Quantenmedizin als theoretische Grundlage setzt es fortschrittliches elektronisches Equipment ein, um das schwache Magnetfeld menschlicher Zellen für wissenschaftliche Analysen aufzufangen, um dadurch den Zustand und die Hauptprobleme der getesteten Person zu analysieren und zu bestimmen und Standard-Präventionsempfehlungen zu unterbreiten.
Der IQ-Well® Quanten Resonanz Magnet Analysator ist ein individualisierter Leitfaden für Beratungen rund um den gesamten Körper, und hat zukunftsweisende Vorteile in Bezug auf Vollständigkeit, ist nicht-invasiv, praktisch, einfach, schnell, wirtschaftlich etc.
Mit der Tiefe und Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung wird es einen großen Beitrag für die Prophylaxe und Körperharmonie leisten und eine breite Entwicklungs- und Anwendungsperspektive haben.

Software Installationsanleitung

Installationsvorgang

1. Nachdem die Installations-CD des IQ-Well® Quantum Resonanz Magnet Analysators in das CD-Laufwerk eingelegt wurde, wird das Installationsprogramm automatisch ausgeführt.
Sollte es nicht automatisch ausgeführt werden, rufen Sie die CD im Arbeitsplatz auf und doppelklicken Sie auf die Datei *Setup. EXE* im Verzeichnis Germany.

Ihr Computer wird dann das Fenster von Abbildung 1 aufrufen, klicken Sie darin auf den Knopf **Weiter**. Sollte die Sicherheitsmeldung:
Möchten Sie zulassen, dass durch diese App von einem unbekannten Heraus-geber Veränderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?
erscheinen, bestätigen Sie bitte mit Ja.

Abb. 1

2. Wählen Sie das Installationsverzeichnis des Programms (wie in Abbildung 2 gezeigt) und die Programmgruppe (wie in Abbildung 3 gezeigt):

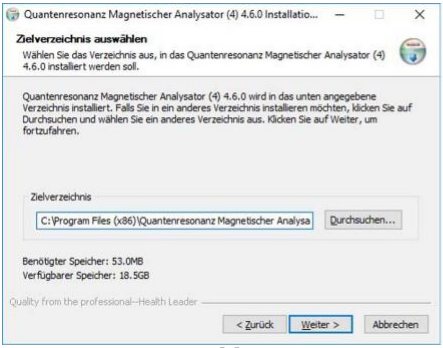

Abb. 2

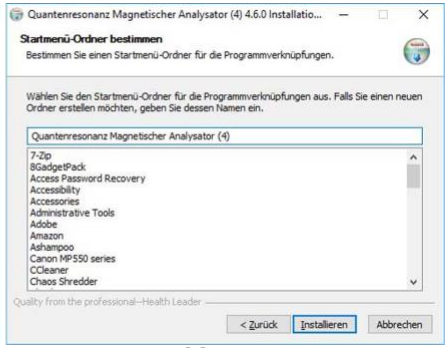

Abb. 3

Nachdem die Auswahl abgeschlossen ist, klicken Sie auf den Button **Installation** um das Programm zu installieren.

3. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **fertig stellen**, wie in Abbildung 4 gezeigt:

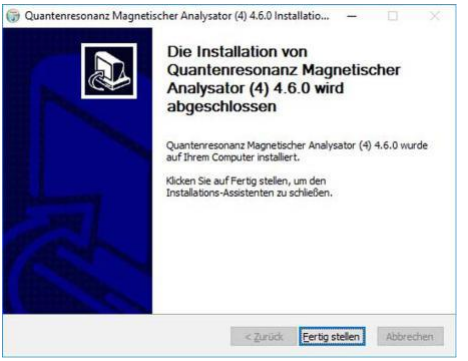

Abb. 4

Wichtiger Hinweis

- Bitte führen Sie den Software-Verschlüsselungs-Stick nicht vor der Installation in die USB-Buchse des Computers ein!
  Stecken Sie den Software-Verschlüsselungs-Stick erst in eine USB-Buchse des Computers ein, wenn die Installation abgeschlossen ist!

- Wenn die Software auf dem Betriebssystem Windows 98 / Me installiert wird, sollte auch Microsoft Office auf dem Computer installiert sein, damit das System normal funktionieren kann. Wenn sie auf dem Betriebssystem Windows 2000 / XP / Windows 7-10 installiert wird, kann das System normal ohne die Unterstützung anderer Software arbeiten;

- Wenn das Licht des Software-Verschlüsselung Sticks immer leuchtet, funktioniert das System normal; Wenn das Licht flackert oder nicht leuchtet, ist die Installation fehlgeschlagen, Sie sollten sich in dem Fall mit Ihrem Händler in Verbindung setzen.

Software Anleitungen

Hauptmenu

1 Starten Sie das System

Klicken Sie in der Startleiste auf „Programm-> Quantum Resonanz Magnet Analysator (4)-> Quantum Resonanz Magnet Analysator (4)„ oder doppel-klicken Sie direkt auf das Verknüpfungssymbol (das folgende Bild) auf dem Desktop:



2 Hauptschnittstelle

Die Meridian-Test-Hauptschnittstelle sieht wie in der folgenden Abbildung aus:

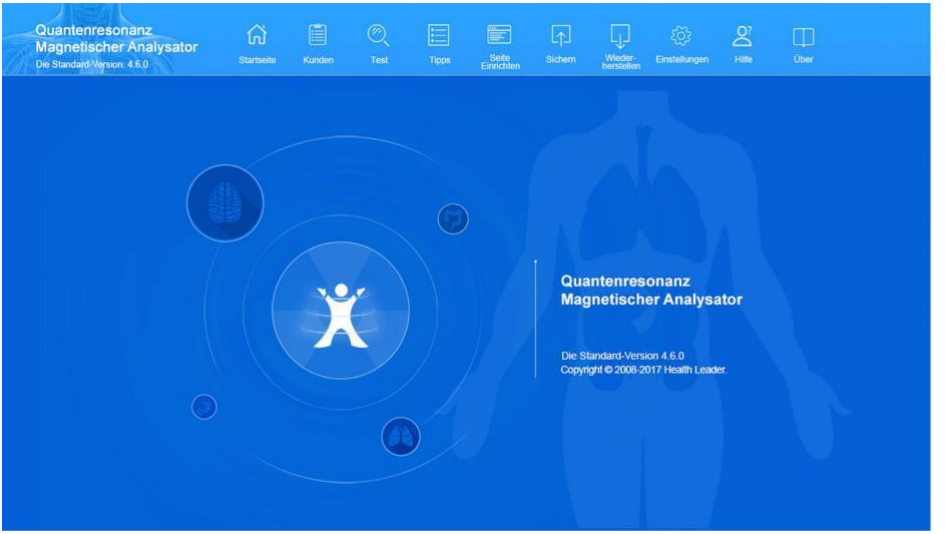

Systemschnittstelle

Kundenverwaltung

Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button **Kunden**, so erscheint das Fenster wie in der folgenden Abbildung. Dieses Fenster verwaltet die Basisinformationen aller getesteten Personen, wobei auf der linken Seite die Verwaltungsdateien des Kunden gelistet sind und die rechte Seite die „Hauptinformationen“ und „Prüfprotokolle“ des ausgewählten Kunden zeigt.

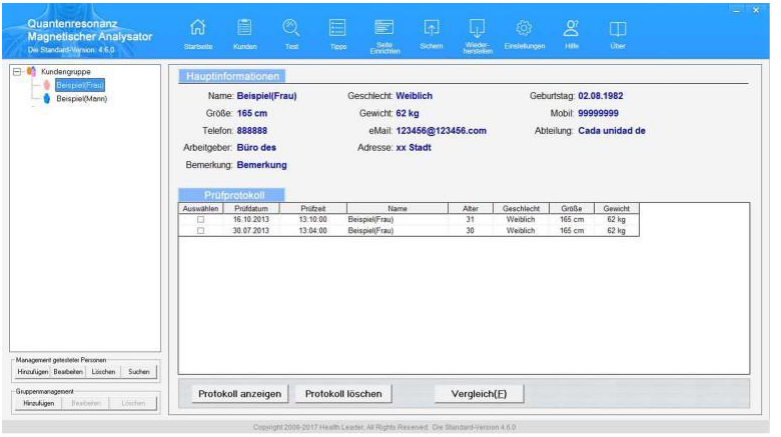

1. Dateiverwaltung der Kunden

Verwalten Sie hauptsächlich die Kundeninformationen, einschließlich:

- **Hinzufügen** von Testpersonen und Gruppen
- **Ändern** Sie die Informationen der Testpersonen und Gruppen
- **Löschen** Sie die Informationen der Testpersonen und Gruppen
- **Fragen** Sie Testpersonen ab



2. Gruppen Management

Damit Sie die Kunden einfacher verwalten können, unterteilen Sie sie in mehrere Gruppen.

Drücken Sie den Knopf **Hinzufügen** in den Gruppen, um eine neue Gruppe hinzuzufügen.
Klicken Sie auf den Button **Speichern**, um den Eintrag hinzuzufügen.

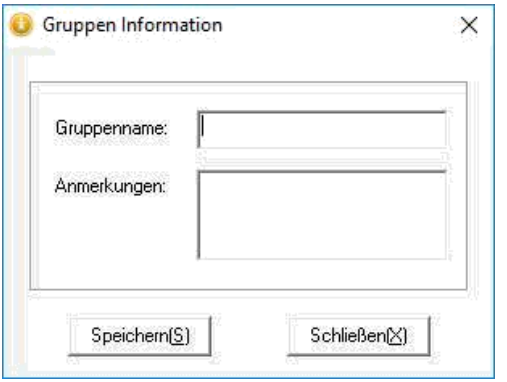

Klicken Sie auf den Button **Bearbeiten**, um einen Eintrag zu ändern und klicken Sie auf den Button **Löschen**, um eine Gruppe zu löschen.
(Hinweis: wenn sich Personen in einer zu löschenden Gruppe befinden, müssen Sie die getesteten Personen zuerst löschen, dann können Sie die Gruppe löschen.)

3. Testpersonen Management

Klicken Sie auf den Namen einer Gruppe auf der linken Seite, so dass er blau wird und drücken Sie dann den Button **Hinzufügen**, im Feld **Management getesteter Personen**, um eine neue Person in der entsprechenden Gruppe hinzuzufügen.

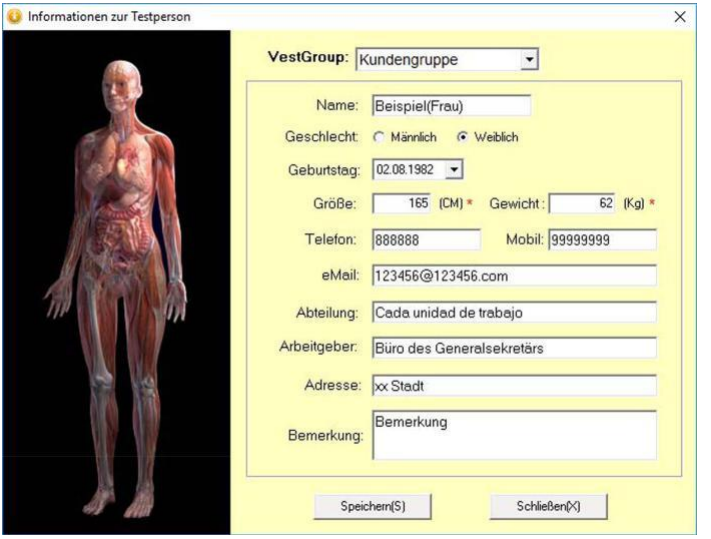

Welche Informationen über einen Kunden eingegeben werden können, sehen in der Abbildung. Angaben über Name, Geschlecht, Geburtsdatum (Tag-Monat-Jahr), Größe und Gewicht müssen eingegeben werden, alle anderen Informationen **können** eingetragen werden, dürfen aber auch fehlen.

4. Prüfprotokoll Management

Verwalten Sie die Testergebnisse der Kunden (siehe nachfolgende Abbildung) mit der Angabe über Testdatum, Testzeit, Name, Alter und Geschlecht. Markieren Sie den gewünschten Kunden in der linken Spalte, so werden die Details aller Prüfprotokolle des Kunden angezeigt (aufgereiht in umgekehrter chronologischer Reihenfolge).

Prüfprotokoll

Auswählen	Prüfdatum	Prüfzeit	Name	Alter	Geschlecht	Größe	Gewicht
☐	16.10.2013	13:10:00	Beispiel(Frau)	31	Weiblich	165 cm	62 kg
☐	30.07.2013	13:04:00	Beispiel(Frau)	30	Weiblich	165 cm	62 kg

Test starten

Klicken Sie auf der linken Seite den Kunden an, der getestet werden soll, damit der Eintrag blau wird. Drücken Sie anschließend in der oberen Menü Leiste den Button **Test**, so dass Sie das folgende Bild sehen. Drücken Sie anschließend den Button **Start** wie in der Abbildung zu sehen.

Prüfvorgang

Bitten Sie die Testperson, die Prüfsonde mit der rechten oder linken Hand zu umfassen, die Testperson soll dabei entspannt sein, nicht sprechen und gleichmäßig atmen. Die Schläfenelektroden sollten ebenfalls angelegt sein. Klicken Sie dann **Test beginnen** an. Der Test beginnt nun.

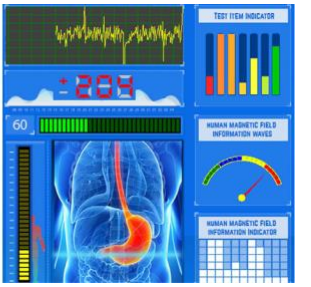

Test beenden

Wenn der Prüfvorgang beendet ist, klicken Sie auf den Button **Speichern**.

Abrufen des Berichts

1 Nach Abschluss des Prüfvorgangs ruft das System automatisch die Schnittstelle zur Kundenverwaltung auf, wählt die getestete Person und das Prüfprotokoll aus und zeigt den gerade erstellten Test an.
Das angezeigte Protokoll kann in verschiedenen Formaten (HTML, ZIP, PDF) gespeichert werden, um es zum Beispiel zu versenden.

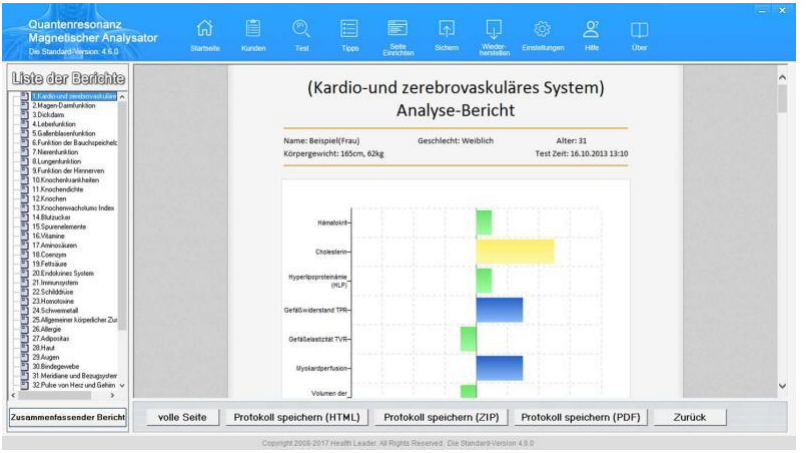

Jedes gespeicherte Protokoll kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder angezeigt werden. Machen Sie Häkchen an das Protokoll, das Sie sehen möchten und klicken Sie auf **Protokoll anzeigen**.

2 Auf der linken Seite der Protokollanzeige befindet sich eine Liste der einzelnen Prüfberichte. Die Details für einen Bericht werden angezeigt, sobald Sie auf ein Thema klicken. Die Schaltfläche **zusammenfassender Bericht** links unten wertet alle Tests aus und gibt Expertentipps dazu an.

3 Wenn der Bericht wie im letzten Bild gezeigt wird, kann er auf einer ganzen Seite angezeigt und gedruckt werden, und Therapeuten können ein Rezept aus-schreiben.

4 Nach dem Klick auf den Button **volle Seite** wird der Bericht wie in der folgenden Abbildung angezeigt. Hier kann der Bericht bearbeitet werden, wie **Drucken**, **Vorschau**, **Speichern**, **Seiten Einrichtung** usw.

In der Vergleichsanalyse können Sie zwei Analyseberichte von einer Person auswählen, machen Sie ein Häkchen an die Protokolle, die Sie sehen möchten und klicken Sie auf den Button **Vergleich**.

Es wird in zwei Abschnitten übereinander jeweils der zusammenfassende Bericht des ausgewählten Datums angezeigt.

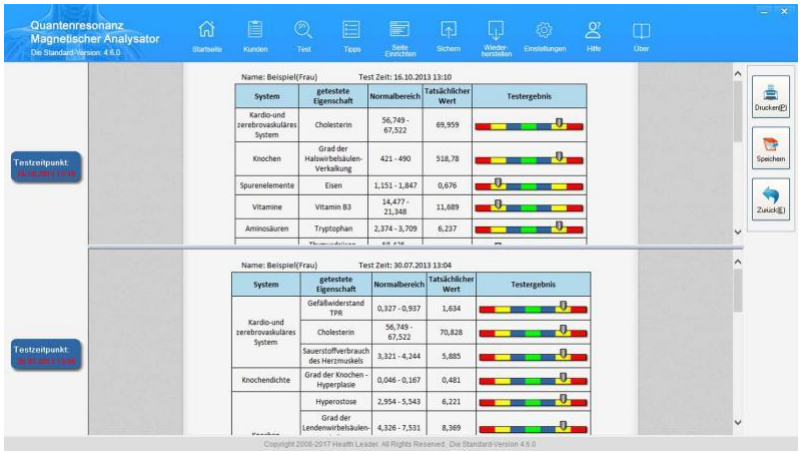

Verwaltung der Experten Tipps

Nach einem Test erscheint der entsprechende Expertenrat automatisch im zusammenfassenden Bericht.
Klicken Sie im Hauptmenu auf die Symbolleiste **Tipp**, damit der Inhalt, der im folgenden Bild gezeigt wird, angezeigt werden kann. Der Benutzer kann die vom System vorgeschlagenen Texte entsprechend ändern und hinzufügen. Dieser Expertenrat läßt sich so bei Bedarf anpassen.
Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, müssen Sie die Schaltfläche **Speichern** anklicken, um geänderte Tipps zu speichern.

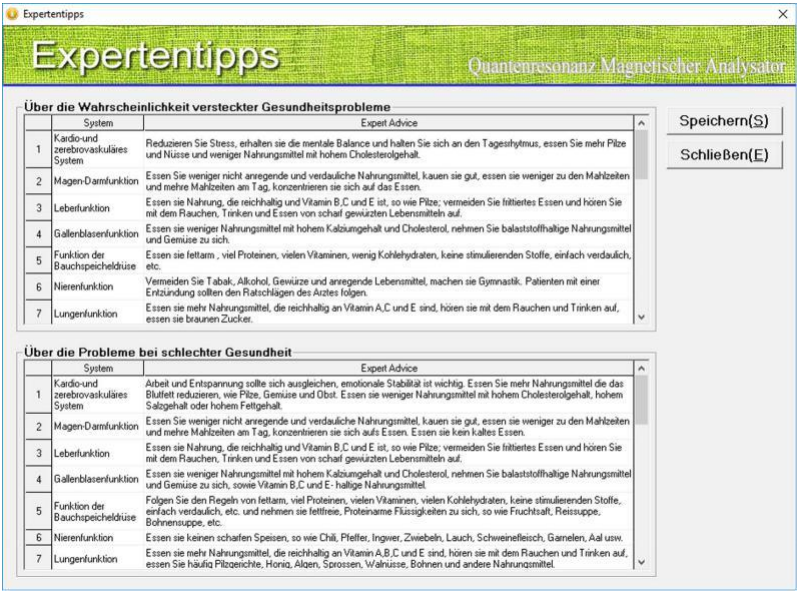

	System	Expert Advice
1	Kardio-und zerebrovaskuläres System	Reduzieren Sie Stress, erhalten sie die mentale Balance und halten Sie sich an den Tagesrhytmus, essen Sie mehr Pilze und Nüsse und weniger Nahrungsmittel mit hohem Cholesterolgehalt.
2	Magen-Darmfunktion	Essen Sie weniger nicht anregende und verdauliche Nahrungsmittel, kauen sie gut, essen sie weniger zu den Mahlzeiten und mehre Mahlzeiten am Tag, konzentrieren sie sich auf das Essen.
3	Leberfunktion	Essen sie Nahrung, die reichhaltig und Vitamin B,C und E ist, so wie Pilze; vermeiden Sie frittiertes Essen und hören Sie mit dem Rauchen, Trinken und Essen von scharf gewürzten Lebensmitteln auf.
4	Gallenblasenfunktion	Essen sie weniger Nahrungsmittel mit hohem Kalziumgehalt und Cholesterol, nehmen Sie balaststoffhaltige Nahrungsmittel und Gemüse zu sich.
5	Funktion der Bauchspeicheldrüse	Essen sie fettarm , viel Proteinen, vielen Vitaminen, wenig Kohlehydraten, keine stimulierenden Stoffe, einfach verdaulich, etc.
6	Nierenfunktion	Vermeiden Sie Tabak, Alkohol, Gewürze und anregende Lebensmittel, machen sie Gymnastik. Patienten mit einer Entzündung sollten den Ratschlägen des Arztes folgen.
7	Lungenfunktion	Essen sie mehr Nahrungsmittel, die reichhaltig an Vitamin A,C und E sind, hören sie mit dem Rauchen und Trinken auf, essen sie braunen Zucker.

	System	Expert Advice
1	Kardio-und zerebrovaskuläres System	Arbeit und Entspannung sollte sich ausgleichen, emotionale Stabilität ist wichtig. Essen Sie mehr Nahrungsmittel die das Blutfett reduzieren, wie Pilze, Gemüse und Obst. Essen sie weniger Nahrungsmittel mit hohem Cholesterolgehalt, hohem Salzgehalt oder hohem Fettgehalt.
2	Magen-Darmfunktion	Essen Sie weniger nicht anregende und verdauliche Nahrungsmittel, kauen sie gut, essen sie weniger zu den Mahlzeiten und mehre Mahlzeiten am Tag, konzentrieren sie sich aufs Essen. Essen sie kein kaltes Essen.
3	Leberfunktion	Essen sie Nahrung, die reichhaltig und Vitamin B,C und E ist, so wie Pilze; vermeiden Sie frittiertes Essen und hören Sie mit dem Rauchen, Trinken und Essen von scharf gewürzten Lebensmitteln auf.
4	Gallenblasenfunktion	Essen sie weniger Nahrungsmittel mit hohem Kalziumgehalt und Cholesterol, nehmen Sie balaststoffhaltige Nahrungsmittel und Gemüse zu sich, sowie Vitamin B,C und E- haltige Nahrungsmittel.
5	Funktion der Bauchspeicheldrüse	Folgen Sie den Regeln von fettarm, viel Proteinen, vielen Vitaminen, vielen Kohlehydraten, keine stimulierenden Stoffe, einfach verdaulich, etc. und nehmen sie fettfreie, Proteinarme Flüssigkeiten zu sich, so wie Fruchtsalt, Reissuppe, Bohnensuppe, etc.
6	Nierenfunktion	Essen sie keinen scharfen Speisen, so wie Chili, Pfeffer, Ingwer, Zwiebeln, Lauch, Schweinefleisch, Garnelen, Aal usw.
7	Lungenfunktion	Essen sie mehr Nahrungsmittel, die reichhaltig an Vitamin A,B,C und E sind, hören sie mit dem Rauchen und Trinken auf, essen Sie häufig Pilzgerichte, Honig, Algen, Sprossen, Walnüsse, Bohnen und andere Nahrungsmittel.

Kopf-und Fußzeile

Wählen Sie im Hauptmenu den Button **Seite einrichten**. Geben Sie die Kopf- und Fußzeile und deren Position (links, Mitte und rechts) ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Speichern**, damit die Kopf- und Fußzeile des Berichts Ihren Vorstellungen entsprechend eingerichtet werden kann.

Sichern und Wiederherstellen der Datenbank

Das System unterstützt das Sichern und Wiederherstellen der vorhandenen Datenbank, sodass die vollständigen Daten wieder hergestellt werden können, um einen Verlust zu reduzieren, wenn der Computer Probleme hat oder von Viren befallen wird.
Klicken Sie im Hauptmenu in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Sichern** oder die Schaltfläche **Wiederherstellen**, um das entsprechende Programm zu öffnen. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **Beginnen**, um den Speicherpfad und den Dateinamen der Sicherungsdateien zu bestimmen.
Hinweis: Während der Wiederherstellung von Daten wird das System automatisch die vorhandene Datenbank überschreiben. Daher muss die Funktion sorgfältig verwendet werden, wenn die vorhandene Datenbank wichtige Daten enthält.

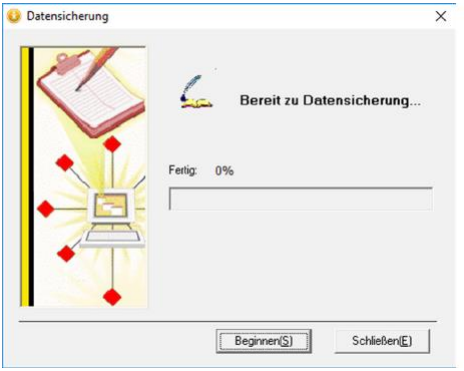

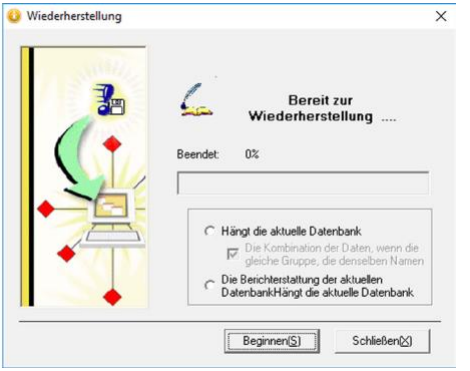

System Setup

Hauptsächlich werden verschiedene Dinge des Systems zur Personalisierung eingerichtet, um das Testergebnis besser auf die Anforderungen des Benutzers und die seiner Kunden abzustimmen. Klicken Sie auf die Buttons (wie im folgenden Bild gezeigt), um Bericht-Einstellungen, Parameter-Einstellungen und Empfindlichkeits-Einstellungen einzugeben.

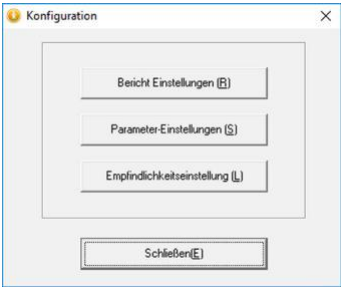

- Berichteinstellungen: Wählen Sie die gewünschten Berichte gemäß den Anforderungen Ihrer Kunden aus und überprüfen Sie die Berichte, die nicht benötigt werden.
- Parametereinstellungen: Richten Sie ein, ob die Details jedes Parameters im Bericht angezeigt werden sollen und die Details angezeigt werden können oder nicht.
- Empfindlichkeitseinstellung: Die Empfindlichkeitseinstellung dient zur Einstellung der Empfindlichkeit der Handsonde des Geräts. Zum Beispiel wird der Wert automatisch arbeiten, wenn das Instrument besonders empfindlich ist, so dass Sie die Empfindlichkeit angemessen senken können. Wenn das Testen für einige getestete Personen schwierig ist, können Sie die Empfindlichkeit entsprechend erhöhen.

Hilfe

Nach dem Anklicken des Buttons **Hilfe** in der Werkzeugleiste erscheint das in der folgenden Abbildung gezeigte Fenster.

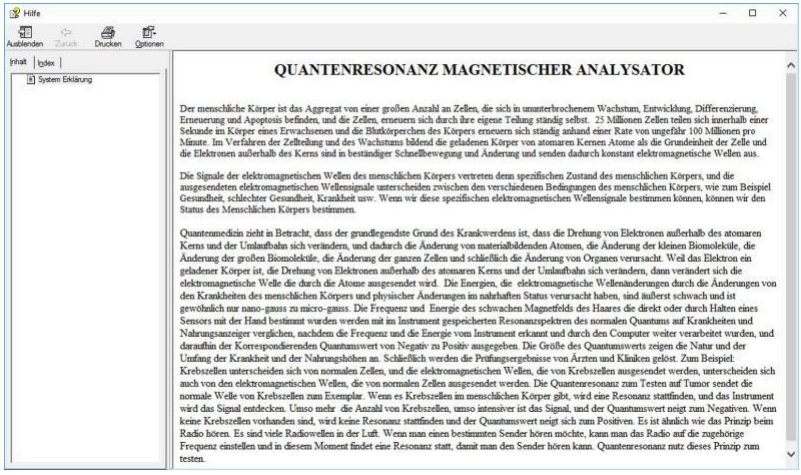

Vorgehensweise für die Prüfung

Prüfverfahren

1 Während die Stromversorgung des Computers noch nicht eingeschaltet ist, überprüfen Sie, ob der Computer, der Sensor, der Sicherheit USB Stick und andere Geräte ordnungsgemäß angeschlossen sind. Die Sonde, die Elektroden und das USB Kabel des IQ-Well® Gerätes müssen fest eingesteckt sein.

2 Starten Sie den Computer und prüfen Sie, ob alle beteiligten Geräte einwandfrei funktionieren.

3 Schließen Sie alle Anwendungsprogramme und öffnen Sie das Programm Quantum Resonanz Magnet Analysator (4).

4 Erhebung und Speicherung der Grunddaten (Name, Geschlecht, Geburtsdatum usw.) der zu testenden Person oder Markierung, falls sie schon einmal als Klient aufgenommen worden ist.

5 Fordern Sie die zu testende Person auf, sich zu entspannen, nicht zu sprechen und ruhig zu atmen.

6 Nachdem die Schläfen-Elektroden angebracht sind, fordern Sie die Testperson auf, die Handsonde mit der linken oder rechten Hand zu umschließen.

7 Während der Prüfung sollte die Haut der Testperson nicht berührt werden, deren Hand sollte die Handsonde natürlich drücken und nicht wackeln.

8 Nach Abschluss des Tests sollten das Gerät und die Handsonde gereinigt/ desinfiziert werden. Die Elektroden sind für einmaligen Gebrauch vorgesehen. Sie können bei der gleichen Person jedoch auch mehrmals verwendet werden.

Arbeitsbedingungen im Testraum

1 Halten Sie den Testraum sauber und ruhig und achten Sie auf elektrische Sicherheit.

2 Vor dem Test sollten Metall- und Kommunikationsgeräte vom Körper der testenden Person entfernt werden, um eine ordnungsgemäße Aufnahme zu gewährleisten.

3 Diejenigen, die einen Herzschrittmacher tragen, dürfen nicht getestet werden!

4 Überprüfen Sie während der Arbeit, ob sich das Netzteil und das Testsystem in einem guten Gebrauchszustand befinden.

5 Für den gesamten Testablauf muss die Bedienungsanleitung strikt eingehalten werden.

6 Wenn das Gerät nicht benutzt wird, sollte die Stromversorgung ausgeschaltet sein (USB-Kabel abziehen). Reinigen Sie das Gerät und die benutzten Teile nach Gebrauch, damit sie jederzeit in einem guten Zustand sind.

Wichtiger Hinweis für die getestete Person

1 Sie sollten keinen Wein und keinen Kaffee trinken, keine Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen und zwei Tage vor dem Test keine Medikamente einnehmen, wenn möglich!

2 Führen Sie zwei Tage vor dem Test ein normales Leben und schlafen Sie normal.

3 Nach einer intensiven Aktivität sollten Sie vor dem Test eine Ruhe Phase von 1-2 Stunden einlegen.

4 Die Tests sollten im Halb-Fasten durchgeführt werden.

5 Für den Test kleiden Sie sich locker und warm.

6 Entspannen Sie während des Tests, sprechen Sie nicht und atmen Sie ruhig.

Aufgaben der testenden Person (Operator)

1 Die Technik des IQ-Well® Quantum Resonanz Magnet Analysators ist sehr genau, so dass die bedienende Person engagiert und unvoreingenommen lernen kann, aktiv Erfahrungen zu sammeln und die eigene Testtechnik kontinuierlich zu verbessern.

2 Während der Arbeit sollte der Operator ruhig und freundlich sein, die getestete Person mitfühlend behandeln, ernsthaft und korrekt agieren und punktgenau seine Auswahl in der Software treffen.

3 Vor dem Test sollte die testende Person die Größe, das Gewicht, den Blutdruck und den Puls der getesteten Person messen und notieren.

Einverständniserklärung

Lassen sie sich von der getesteten Person eine Einverständniserklärung zum eigenen Schutz unterschreiben.

Hier ein Formulierungsvorschlag:

Diese IQ-Well® Scan Untersuchung wurde auf eigenen Wunsch durchgeführt. Sie ersetzt keine schulmedizinische Untersuchung, liefert aber wertvolle Erkenntnisse über den energetischen Körper des Menschen.
Wir behandeln Ihre persönlichen Daten streng vertraulich. Sie werden an Dritte nicht weitergegeben.

Unsere Empfehlung

Die Ergebnisse der Scan Analyse die 110 Seiten lang sind, sollte der getesteten Person nicht ausgehändigt werden. Sie können die letzte Seite (Nr. 38) „Experten –Analyse Bericht“ ausgedruckt werden.
Der Operator sollte für Reinigung, Wartung und Lagerung des Test Gerätes und der entsprechenden Zubehörteile des IQ-Well® Quantum Resonanz Magnet Analysator verantwortlich sein.

Wartungsmethoden für den Operator

1 Das Software- und Hardwaresystem muss gemäß der Bedienungsanleitung installiert werden.

2 Der IQ-Well® Quantum Resonanz Magnet Analysator ist ein elektronisches Produkt mit hoher Empfindlichkeit. Es sollte keinen Erschütterungen und Stößen ausgesetzt werden.

3 Es ist strengstens verboten, das Gerät an einem heißen, feuchten, aggressiven oder radioaktiven Ort zu bedienen oder es direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.

4 Wenn das Gerät nicht verwendet wird, wird die Handsonde mit einem Stück weichen Tuch oder einem Wattebausch abgewischt und dann in der Verpackung aufbewahrt.

5 Das Kabel des Sensors sollte nicht überdehnt oder geknickt werden, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

6 Es ist streng verboten, den Sensor zu zerlegen.

Service und Wartung

Sehr geehrte Benutzer, herzlichen Glückwunsch zum Kauf des IQ-Well® Quanten Resonanz Magnet Analysators. Sollten Sie bei der Verwendung des Gerätes Probleme haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Garantie

1 Sollten innerhalb von drei Monaten ab Kaufdatum Qualitätsprobleme auftreten, kann das Gerät durch ein neues ersetzt werden.
2 Die Garantiezeit des Herstellers beträgt ein Jahr.
3 Nach Ablauf der Garantiezeit ist ausschließlich unsere Firma für die Wartung zuständig, es werden Bearbeitungsgebühr und Ersatzteilkosten berechnet.

In folgenden Fällen erlischt die kostenlose Garantieleistung:

1 Wenn das Gerät durch menschliches Einwirken beschädigt oder zerbrochen wurde, kann es nicht ersetzt werden.
2 Wenn es durch unbefugte Demontage oder Nachrüstung beschädigt worden ist, kann es nicht ersetzt werden.
3 Wenn es wegen unsachgemäßer Verwendung beschädigt wird, kann es nicht ersetzt werden.

Wenn es ein Problem gibt, rufen Sie bitte die Verkaufsstellen unseres Unternehmens an und wir werden das Problem so schnell wie möglich für Sie lösen.

Statement

Das Eigentumsrecht und das Urheberrecht an dem Programm (einschließlich aller Bilder, Fotos, Animationen, Videoaufnahmen, Musik, Charaktere und weiterer Verfahren sowie die beigefügten Drucksachen und Kopien des Programms gehören dem Unternehmen. Ohne Erlaubnis dürfen Sie das Programm und alle relevanten Informationen weder ganz noch teilweise zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form veröffentlichen, oder Sie werden strengen zivil- und strafrechtlichen Sanktionen unterworfen und im gesetzlich zulässigen Umfang einer größtmöglichen zivilrechtlichen Klage unterworfen.
Alle Rechte, die nicht ausdrücklich durch diese Erklärung gewährt werden, bleiben vorbehalten. Die Namen der in diesem Programm erwähnten tatsächlichen Firmen und Produkte können Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein.

Reklamationsnummer _____

Reklamationsschein für **IQ-Well®** Produkte

Bitte alle Formularfelder vollständig ausfüllen und zusammen mit der Rechnungskopie beifügen!

Kunden- Nr.
Vor- und Nachname / Firma
Adresse
E-Mail / Telefonnummer
Rechnungs-Nr.
Rechnungsdatum
Lieferdatum

Folgende Artikel werden vollständig und originalverpackt zurück-gesendet:

Menge	Geräte-Serien Nr.	Artikel-Bezeichnung
.		
2.		
3.		
Fehlerbeschreibung:		

Ihre Wünsche:

Datum / Unterschrift:

Notizen:

10-WELL
SCAN
10-WELL

Stempel/Adresse des Fachhändlers

Copyright © 2019 IQ-Well®
Österreich : www.iq-well.com