Teil I

IQ-WELL Alpha

Bedienungsanleitung

Das Gerät ist zur aktiven Herstellung eines ganzheitlichen Wohlbefindens bestimmt.

Inhaltsverzeichnis 2-3

1. Einführung 4

2. Wichtige Hinweise zu Beginn 4

2.1 Sicherheitshinweise 4-5

2.2. Kontraindikationen 5

3. Bestimmung des Gerätes IQ - Well Alpha 5-6

4. Lieferumfang 7

5. Geräte-Beschreibung 8

5.1 Geräte-Steuerung 8

5.2 Frontansicht 8

5.2.1 Display 8

5.3 Rückseite 9

5.4 Anschlussstelle für Kabel 9

5.5 Ladegerät 10

5.5.1 Lade Vorgang 10

6. Inbetriebnahme 11

6.1 Gerät einschalten 11

6.2 Ausschallten 11

6.3 Hauptmenü -Vier graphische Symbole 11

7. Symbol „Daten“ 12

8. Symbol „Einstellungen“ 12-13

9. Symbol „Programm“ 14-15

10. Programm- Beschreibung, Funktionen 16

10.1 Programm 1 17

10.2 Programm 2  17-18

10.3 Programm 3 18-19

10.4 Programm „ Aufnahme“(REC) 19

10.4.1 Durchführung 20-21

10.5 Programm „Wasser-Strukturierung“ 22

10.5.1 Einleitung 22-23

10.5.2 Vorbereitung 23

10.5.3 Strukturierung starten 23-24

11. Symbol „Info“ 24

11.1 Anwendung Zonen 24-25

11.2 Akupunktur Punkte 25-28

11.3 Anti- Stress Anwendung 29

12. Anwendung im täglichem Leben 29

13. Fazit 30

1. Einführung

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben! Mit diesem Gerät haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben. Damit Sie den gewünschten Erfolg erzielen und lange Freude haben, lesen Sie die Hinweise zum Gebrauch und zur Pflege sorgfältig durch und befolge Sie diese!

In Osteuropa besteht ein grundlegend anderes Verständnis der energetischen Dimensionen des Menschen. Es werden neue Methoden wissenschaftlich erforscht, die bei uns als alternativ gelten und die wissenschaftlich noch nicht anerkannt sind. Immer mehr Menschen gehen diese neuen Wege. Es freut uns sehr, dass auch Sie sich für diese neuen Technologien interessieren.

2. Wichtige Hinweise zu Beginn

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, legen Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung bei. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Schäden am Gerät führen.

2.1 Sicherheitshinweise

Folgende Hinweise bzw. Warnungen sind zur Verhinderung möglicher Beschädigungen am Gerät einzuhalten und geben nützliche Informationen zum Betrieb:

- Bevor Sie das Gerät einschalten, überprüfen Sie dieses auf mechanischen Schäden.
- Bei Erkennung eines Fehlers während der Anwendung ist der Gebrauch zu unterbrechen und das Gerät auszuschalten.
- Das Gerät, seine Teile und Anschlussstellen dürfen dem Kontakt mit Wasser nicht ausgesetzt werden.
- Das Gehäuse des Gerätes wird ohne Verwendung von schädlichen chemischen Substanzen hergestellt.
- Schützen Sie das Gerät gegenüber elektrostatischen Ladungen.

- Es ist nicht gestattet, andere als das mitgelieferte Kabel zu verwenden.
- Um Schäden am Gerät und/oder an den Kristall Emittern zu verhindern, ist es dringend zu vermeiden,
    - das Gerät Stößen und übermäßigen mechanischen Belastungen auszusetzen und
    - die Kristall Emitter in die Hände von Kindern zu geben, da eine Verschluckungsgefahr besteht.
- Das Gerät kann in Räumen bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10 °C und +35 °C und einer Luftfeuchtigkeit von maximal 80 % genutzt werden.

2.2 Kontraindikationen

Vorsicht ist geboten:

- bei Personen die zu Blutungen neigen
- bei Kindern bis zum 1. Lebensjahr
- bei nicht bekannter Diagnose
- bei Schwangerschaft
- bei Patienten mit Epilepsie
- bei Menschen mit implantierten Geräten mit autonomer Stromversorgung

z B. Herzschrittmacher: verwenden Sie das Gerät nicht im Brustbereich
Hörimplantat - verwenden Sie das Gerät nicht in dem Ohrbereich.

Die Anwendungen werden als begleitende Unterstützung zur Basistherapie empfohlen.

3. Bestimmung des Gerätes „IQ–Well Alpha

Wir haben für Sie ein Zukunftsorientiertes Produkt aus russischer Weltraumforschung auf Basis der Bioinformation und Quantentechnologie entwickelt.

Das IQ-Well Alpha Gerät ist für die aktive Herstellung eines ganzheitlichen Wohlbefindens bestimmt und harmonisiert und aktiviert bei allen Lebewesen die Bio,- und Energiesysteme, die über einen hohen Wasseranteil verfügen.

Jeder Anwender kann das Gerät für die eigenen, individuellen Bedürfnisse verwenden. Es ist überall und zu jeder Zeit einsetzbar. Die positive

Wirkung auf das Wasser ermöglicht vielseitige Anwendungen bei Menschen, Tieren und auch Pflanzen.

Die aktive Wirkung wird durch die einzigartigen physikalischen Eigenschaften von Indium-Phosphid-Kristallen (InP. Gruppe A3B5) erzielt. Das Gerät IQ-Well Alpha nützt Millimeterwellen im Frequenzen-Bereich von 40 GHz bis 70 GHz. Das sind Frequenzen, mit welchen unsere Zellen und Organe untereinander kommunizieren.

Das IQ-Well Alpha wirkt:

- strukturierend auf das Wasser im menschlichen Körper. Dieses erfüllt grundsätzlich mehrere Funktionen: es transportiert und überträgt Informationen, wodurch viele biochemische Reaktionen und funktionale Prozesse an der Organ-Ebene beeinflusst werden können.
- auf die körpereigene Selbstregulation und bringt den synchronisierenden Mechanismus auf ein stabiles Niveau.
- Systemisch. Das bedeutet, dass alle Organe gleichzeitig in Harmonie gebracht werden und die Millimeterwellen nicht nur dort lokal wirken, wo der Kristall angelegt wird, sondern auf den ganzen Körper.

Mit dem IQ-WELL-Alpha Gerät können Sie:

- Wasser und Produkte auf Wasserbasis strukturieren
- Spannungen und Nervosität abbauen – Antistress Wirkung
- Vitalität, Leistungsfähigkeit und Kondition stärken
- Beschwerden durch verbesserte Zellenkommunikation lindern
- Merk-, Lern- und Konzentrationsfähigkeiten verbessern
- Akkupunktur Punkte und Meridiane aktivieren

4. Lieferumfang

(Abb. 1)

Bitte prüfen Sie zunächst, ob die Lieferung vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung die folgenden Teile enthält:

- IQ-WELL Gerät Alpha
- fünf Kristalle: zwei gelbe, ein roter, ein blauer, ein grüner
- zwei Verbindungskabel für den Anschluss der Kristall Emitter am Gerät
- Induktions-Ladeplatte mit USB- Kabel samt Stromstecker
- Bedienungsanleitung inkl. technischem Datenblatt

Die mitgelieferten Teile sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen.

5. Geräte-Beschreibung

Das Gerät „IQ-WELL Alpha ist ein handliches, tragbares Gerät, an welches gleichzeitig zwei Kristall Emitter mittels Kabel angeschlossen werden können. Die Stromversorgung erfolgt mittels eines eingebauten Akkus. Bei leerem Akku kann das Gerät auch mit handelsüblichen AA-Batterien betrieben werden.

5.1 Gerätesteuerung

Die Menüsteuerung erfolgt über die Pfeil-Tasten im darunterliegenden Tastenfeld.

(Abb. 2)

5.2 Frontansicht

5.2.1 Display

(Abb. 3)

(Abb. 4)

Nach dem Einschalten des Gerätes erscheint das „IQ-Well“ Logo (Abb. 3) und in Folge die vier graphischen Symbole des Hauptmenüs (Abb. 4). Am Display sind auch eine Zeit- und eine Ladeanzeige ersichtlich.

5.3 Rückseite

An der Rückseite des Gerätes finden Sie 2 Fächer für Kristall-Emitter. Darin können Sie 2 Emitter geschützt aufbewahren (z.B. auf Reisen). (siehe Abb. 5 und 6).

(Abb. 5 geschl.)

(Abb. 6 geöffnet)

5.4 Anschluss -Stelle für Emitter

An der oberen Seite des Gerätes befinden sich zwei Buchsen für den Anschluss des Kabels. Schließen Sie mindestens eines der Kabel an die Buchse an. Am anderen Ende des Kabels befestigen Sie den Kristall Emitter.

Beim Anschließen des Kabels und des Kristall Emitters soll das Gerät ausgeschaltet sein.

(Abb. 7 Gerät mit Kabel)

(Abb. 8 Gerät ohne Kabel)

5.5 Ladegerät

Das Ladegerät besteht aus drei Teilen: Ladeplatte, USB Kabel, Netzstecker.

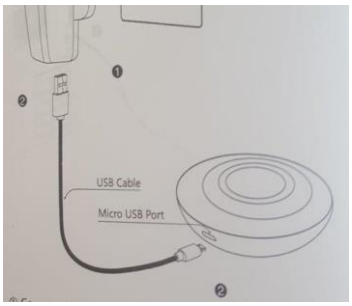

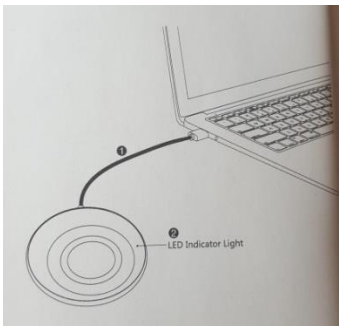

(Abb. 9 Ladegerät)

5.5.1 Ladevorgang

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Verbinden Sie dazu das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss der Platte und einem USB Anschluß des Computers oder Netzsteckers.

Legen Sie das Gerät IQ-Well Alpha mit der Unterseite auf die Ladeplatte. Die maximale Ladezeit beträgt ca. 2 - 2,5 Stunden.

Während des Ladevorganges leuchtet die Ladelampe zwischen den beiden Anschlussstellen ROT (Abb. 10); wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten die Kontrollleuchte und die Ladeanzeige am Display GRÜN (Abb. 11)

(Abb. 10 aktiver Ladevorgang) (Abb. 11 Ladevorgang beendet)

Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte und Ladeanzeige am Display grün.

6. Inbetriebnahme

6.1 Gerät einschalten

Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie die OK-Taste für 1 Sekunde. Nach ca. zwei Sekunden erscheint das „IQ-Well“ Logo am Display und danach erscheint das Hauptmenü mit vier graphischen Symbolen. Es leuchtet das grüne Symbol „Programm“.

6.2 Gerät ausschallten Jeweils nach der letzten Betätigung schaltet sich das Display nach 60 Sekunden automatisch aus, es ertönt ein Signal.

Um Schäden am Bedienfeld zu vermeiden, drücken Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand darauf und üben Sie keinen starken Druck aus. Es wird empfohlen, die Tasten nur mit der Fingerkuppe zu bedienen.

6.3 Hauptmenü - Vier graphische Symbole

Durch die Steuerung mit den Pfeil-Tasten (rechts und links) können Sie das gewünschte Symbol auswählen und mit der „OK“-Taste bestätigen.

Einstellungen

Programm

Info

Daten

(Abb. 12)

7. Symbol „Daten“

(Abb. 13) (Abb. 14)

Durch die Steuerung mit den Pfeiltasten bewegen Sie sich auf dem Display zum Symbol „ Daten“ (Abb. 13) und bestätigen mit der „OK“-Taste.
Hier befinden sich Angaben zum Gerät und Kontaktdaten des Herstellers (Abb. 14).
Mit der „OK“-Taste kommen Sie wieder zurück zum Hauptmenü.

8. Symbol „Einstellungen“

Durch Steuerung mit den „Pfeil“-Tasten bewegen Sie sich auf dem Display zum Symbol „Einstellungen“ und bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

Hier können Sie folgende Möglichkeiten wählen:

- **Ton** - mit OK-Taste bestätigen: es erscheinen vier Ton-Symbole zum Auswählen der gewünschten Lautstärke des Gerätesignal-Tons, welche Sie durch Drücken der „Rechtspfeil“-Taste auswählen und mit der „OK“-Taste bestätigen.

(Abb. 15 - Ton)

- **Sprach**e - mit der „OK“-Taste bestätigen: es erscheinen zwei Symbole – „Englisch“ und „Deutsch“, welche Sie durch Drücken der „Rechtspfeil“-Taste auswählen und mit der „OK“-Taste bestätigen.

(Abb. 16 – Sprache)

Kontrast – mit der „OK“-Taste bestätigen: es erscheinen Zeichen für vier Intensitäten, welche Sie durch Drücken der „Rechtspfeil“-Taste auswählen und mit der „OK“-Taste bestätigen.

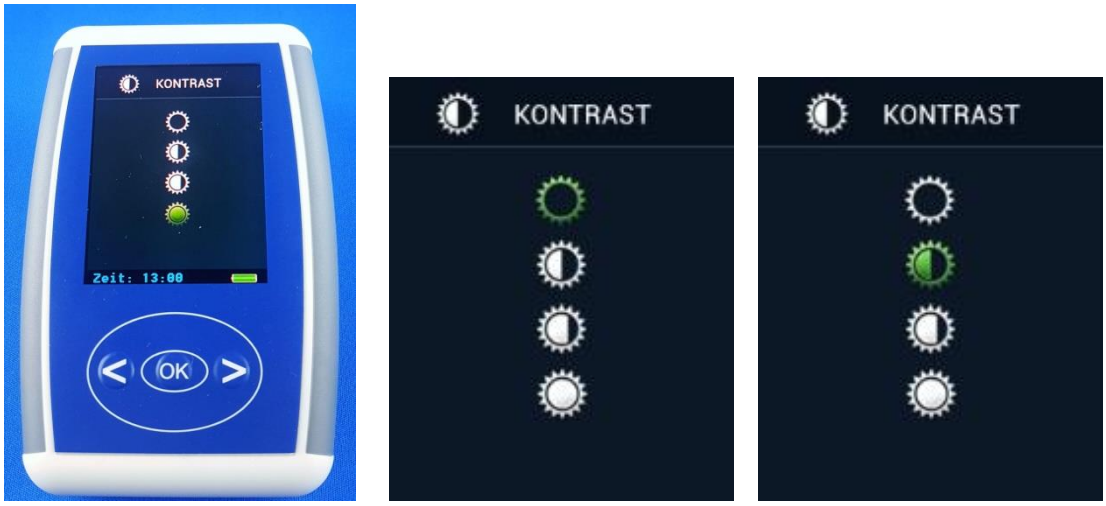

(Abb. 17 – Kontrast)

- **Uhr –** mit der „OK“-Taste bestätigen: es erscheint die Anzeige für „Stunde“, welche mit den Pfeil-Tasten eingestellt und mit „OK“-Taste bestätigt werden kann; anschließend in gleicher Weise die Einstellung der Minuten vornehmen.

Zurück zum Hauptmenü

- Mit der „Rechtspfeil“-Taste weiter wählen bis ein Rückpfeil in Rot erscheint, diesen mit der „OK“-Taste bestätigen und Sie kommen zurück zum Hauptmenü.

9. Symbol „Programm“

(Abb. 18)

Hier können Sie folgende Programme wählen:

Programm 1, 2, 3,

Programm Aufnahme

Programm Wasser strukturieren.

Jedes Programm ist für die speziellen Kristall Emitter in der unterschiedlichen Farbe **GELB**, **ROT**, **GRÜN**, **BLAU** oder **GELB-ROT** durch deren Wellenlänge und Frequenzen bestimmt. Der gelbe Kristall Emitter ist wegen seines Breitfrequenzspektrums universell einsetzbar und ist für alle Anwendungen geeignet.

Kristall Emitter

Wählen Sie das Programm je nach Bedarf sowie die gewünschte Behandlungsdauer in Minuten mit den Pfeiltasten aus und bestätigen mit der „OK“ Taste, wodurch das ausgewählte Programm gestartet wird.

Mögliche **Zeitauswahl**: 5 min. bzw. 10 min. bzw. 20 min. (Abb. 19)

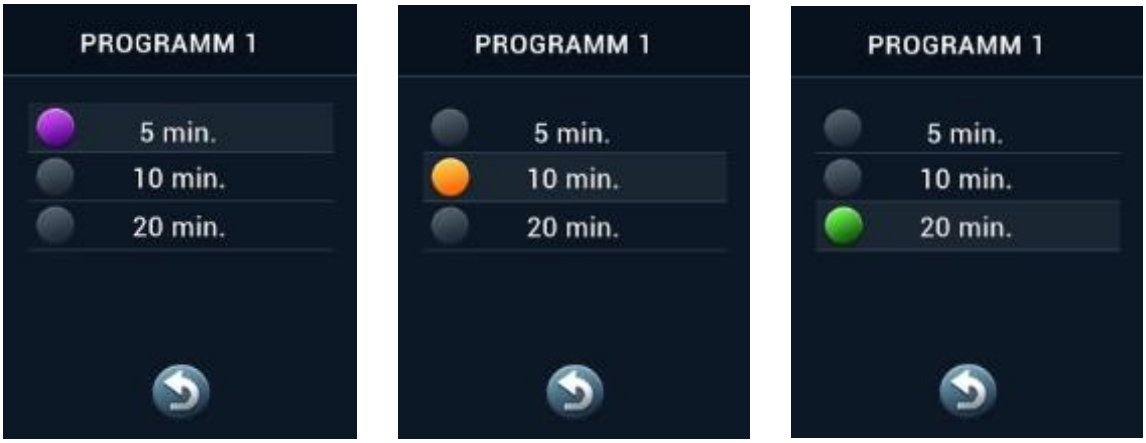

(Abb. 19)

Am Display erscheint zum jeweiligen Kabelanschluss ein Fenster mit „ON“ (grün) oder „OFF“ (rot), welches die Betriebsbereitschaft der am Gerät angeschlossenen Kristall Emitter symbolisiert (Abb. 20):

- „ON“ – betriebsbereit und funktionstüchtig
- „OFF“ – weist darauf hin, dass ein (oder beide) Kabel nicht vollständig eingesteckt oder fehlerhaft sind. Beim Funktionsausfall des Gerätes sind keine Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler.

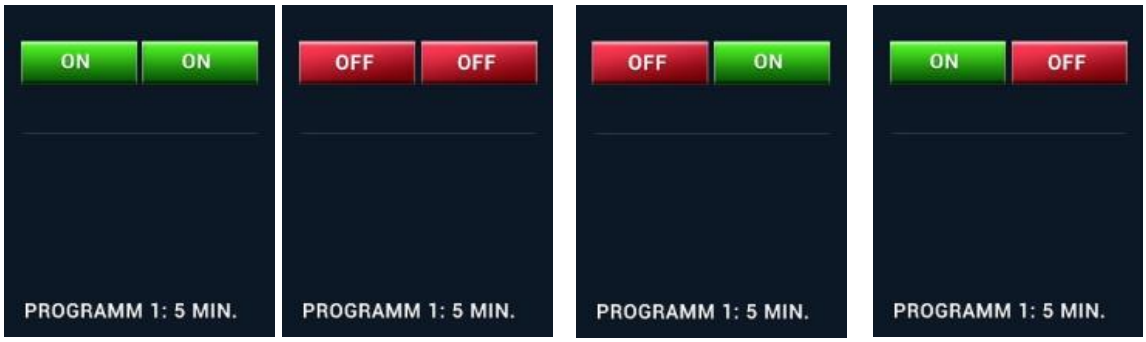

(Abb. 20)

Unten am Display ist ein Zeitbalken ersichtlich, welcher die Rest Zeit des jeweiligen Programms anzeigt.

Gleichzeitig begleitet den Zeitablauf eine sich wiederholende grüne Impuls-Kurve. Beim Programm zur Wasser-Strukturierung wechselt die Impulskurve in ein Wasserrauschen. Nach dem Zeitablauf schaltet sich das Programm automatisch ab.

Im unteren Teil des Displays ist das ausgewählte Programm mit entsprechender Zeitangabe ersichtlich. (Abb. 21)

(Abb. 21)

10. PROGRAMME-BESCHREIBUNG UND FUNKTIONEN

Durchführung:

Siehe Punkt 6.1 Inbetriebnahme und Punkt 9. Symbol „Programm“. Schließen Sie das Kabel an das Gerät (an einen beliebigen Kanal) an. Verbinden Sie den Kristall Emitter mit dem Kabel. **Sie können sowohl einen als auch zwei Kristall Emitter gleichzeitig verwenden**.

Danach wählen Sie das gewünschte Programm und die Zeitdauer. Legen Sie den Kristall Emitter mit der weißen, aktiven Seite auf die entsprechende, von Ihnen ausgewählte Stelle und bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

10.1. Programm 1

Dieses Programm ist das HAUPTPROGRAMM für jede Anwendung und jeden Bedarf .

Verwenden Sie dafür den GELBEN oder ROTEN Kristall Emitter.

Dieses Programm wird mit dem gelben Kristall Emitter der Wellenlänge 3,8 - 5,7mm (52 - 78 GHz) und/oder roten Kristall Emitter der Wellenlänge 7,1 mm (40 - 43 GHz) durchgeführt.

Mit dem Programm 1 können Sie:

- Wasser und Produkte auf Wasserbasis strukturieren
- Vitalität, Leistungsfähigkeit und Kondition stärken
- Beschwerden durch Zellenkommunikation lindern
- Merk-, Lern- und Konzentrationsfähigkeiten verbessern.
- Akkupunktur Punkte und Meridiane aktivieren
- Spannungen und Nervosität abbauen – Antistress Wirkung
  Empfohlene Anwendung auf die Blutgefäße z.B. Pulsadern.

10.2. Programm 2

Siehe Punkt 6.1 Inbetriebnahme und Punkt 9. Symbol „Programm“.
Wählen Sie das Programm 2 mit der linken Pfeiltaste. Legen Sie den Kristall Emitter mit der weißen, aktiven Seite auf die endsprechende, von Ihnen ausgewählte Stelle. Mit der OK-Taste bestätigen.
Wählen Sie die Zeitauswahl. Mit der „OK“-Taste bestätigen.

für BLAUEN und GRÜNEN Kristall Emitter.

Dieses Programm ist für das Lymphatische, das Endokrinne und Nervensystem bestimmt.

Mit dem grünen Kristall Emitter (Lymphatische System) - Wellenlänge 5,6 mm (52-57 GHz). können Sie:

- die Funktionen des lymphatischen Systems unterstützen
- die Entgiftung und Entschlackung des Körpers fördern
- die abschwellende Wirkung bei Verletzungen unterstützen

Empfohlene Anwendung auf Hautprojektion Stellen des lymphatischen Systems. Suchen Sie Informationen im Internet oder in entsprechender Literatur.

Mit dem blauem Kristall Emitter (Endokrine,- und Nerven-System) **-** Wellenlänge 4,9 mm (57-63 GHz) können Sie:

- die Struktur hormonellen (endokrinen) Drüsen regenerieren
- die Impulsleitung der Nervenfasern verbessern
- die Regenerierung von Zellen des Nervensystems fördern
- Spannungen und Nervosität abbauen

Empfohlene Anwendung auf die Hautprojektionsstelle endokriner Drüsen

und in dem Kopfbereich.

10.3. Programm 3 **Siehe Punkt 6.1 Inbetriebnahme und Punkt 9. Symbol „Programm“.**

Wählen Sie das Programm 3 mit der linken Pfeiltaste. Legen Sie den Kristall Emitter mit der aktiven roten Seite auf die endsprechende, von Ihnen ausgewählte betroffene Stelle. Mit der „OK“-Taste bestätigen. Wählen Sie Ihre Zeitauswahl. Mit der „OK“-Taste bestätigen.

GELB-ROT Kristall Emitter der Wellenlänge **2 mm (150 GHz)**

Anwendungen: bei Haut Problemen, Haut-Pilz-Befall, Herpes, Hautausschlägen, Narben.

Wirkungen:

- Erhöhung der Sauerstoff-Sättigung des Blutes und dadurch auch des Sauerstoffgehalts im Gewebe
- Anregung der Ausschüttung des Körpers eigenen Heparin und Verbesserung der Viskosität des Blutflusses
- regenerierend besonders im Haut-Bereich

Dieses Programm wird abwechselnd mit dem gelben Kristall Emitter durchgeführt.

Gelb-roter Kristall Emitter ist nicht in Verpackung vorgesehen!

10.4. Programm „Aufnahme"(REC.)

In diesem Programm können Sie alle farbliche Kristall-Emitter benützen.

(Abb. 22)

Einführung-Programm „Aufnahme“(REC.)

Dieses Programm ermöglicht Ihnen, das Frequenzspektrum bzw. die Information jeder lebenden und nicht lebenden Materie auf das Gitter des Kristall -Emitters zu speichern. Der Kristall- Emitter, welcher mit dem Gerät verbunden ist, nimmt und zeichnet die Informationen der Zellen von den Problemzonen des Körpers auf.

Beim Abspielen der Information am Körper und ins strukturierte Wasser wird die gespeicherte Information übertragen.

Diese Eigenschaft ist absolut einzigartig!

Genauere Informationen betreffend dieses Programm bekommen Sie bei den Schulungen und auf unserer Internetseite.

10.4.1 Durchführung- Programm „Aufnahme“(REC)

Siehe Punkt 6.1 Inbetriebnahme und Punkt 9. Symbol „Programm“.
Wählen Sie das Programm „Aufnahme“ (REC.)
Anschließend legen Sie den Kristall Emitter mit der weißen, aktiven Seite auf die endsprechende, von Ihnen ausgewählte Stelle und bestätigen Sie mit der „OK“-Taste, wonach am Display die Anzeige „REC.“ erscheint.

a) **Das Aufnahme-Programm dauert 1 Minute**.
Der Kristall Emitter speichert währenddessen die Information von dieser Stelle.

(Abb. 23)

b) Danach trennen Sie den Kristall Emitter vom Kabel und befestigen ihn für 8 bis 12 Stunden auf die Ablesestelle (z.B. mittels eines Pflasters oder eines Bandes).

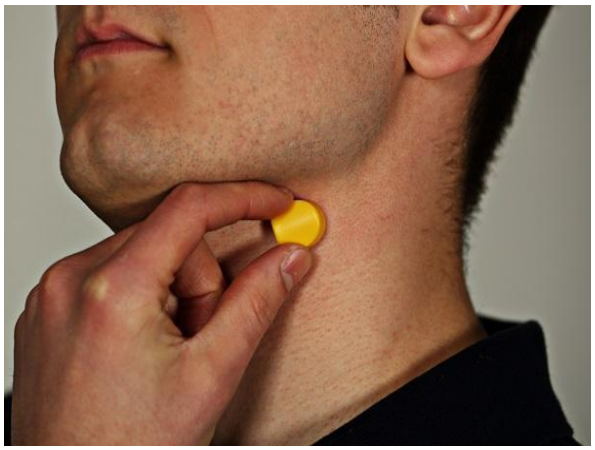

(Abb.24)

Um die Wirkung zu verstärken, können Sie die gespeicherten Informationen des Kristalls Emitters auf ein zuvor strukturiertes Wasser (siehe 9.5 Programm „Wasser-Strukturierung“) 10 bis 15 Minuten lang übertragen. Danach das strukturierte Wasser langsam und schluckweise trinken.

(Abb. 25)

10.5 Programm „Wasser-Strukturierung“

(Abb. 26)

10.5.1 Einleitung- Programm „Wasser-Strukturierung“

Ein sauberes Wasser ist noch lange kein gesundes Wasser!

(Abb. 27)

Das Wasser im menschlichen Körper erfüllt mehrere Funktionen: es strukturiert, transportiert, überträgt Informationen und beeinflusst viele biochemische- funktionelle Prozesse.

Die Effektivität der Wirkung des Gerätes in allen Programmen ist wesentlich abhängig von der optimalen Struktur des Wassers und der ausreichenden Trinkmenge. Das strukturierte Wasser ist das ideale Transportmittel für alle durch den angeregten Stoffwechsel auszuscheidenden Stoffe des Körpers

10.5.2 Vorbereitung- Programm „Wasser-Strukturierung“

Zum Strukturieren des Wassers verwenden Sie ein möglichst dünnes Glasgefäß (am besten einen Becher oder Krug) und kein Plastik- oder Keramikgefäß. Der Behälter darf keine Aufschrift, keinen Schliff und kein Metall enthalten!

10.5.3 Strukturierung starten

Siehe Punkt 6.1 Inbetriebnahme und Punkt 9. Symbol „Programm“.

Halten Sie den Kristall Emitter mit der weißen, aktiven Seite am Behälter mit Wasser oder befestigen Sie den Kristall-Emitter mittels eines Gummibandes oder eines Bandes. Mit der „OK“ –Taste bestätigen. Programmdauer 10 Minuten.

(Abb. 28)

Das Strukturierte Wasser verliert die optimale Struktur durch Einfluss von Elektro- und allen strahlenden Geräten, Sonnenlicht, Erhitzen.
Die Tages-Wasserration wird über den Tag verteilt getrunken.

Erst nach der Wasser-Strukturierung können Informationen auf das Wasser übertragen werden.

Das Eindringen jeglicher Art von Flüssigkeit und Feuchtigkeit in die Anschluss Stelle des Kristall -Emitters Kabel ist strikt zu **vermeiden.**

11. Symbol „Info“

(Abb. 29)

Siehe Punkt 6.1 Inbetriebnahme und Punkt 9. Symbol „Programm“.

Wählen Sie das Symbol „Info“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „OK“-Taste.

11.1 Anwendungszonen

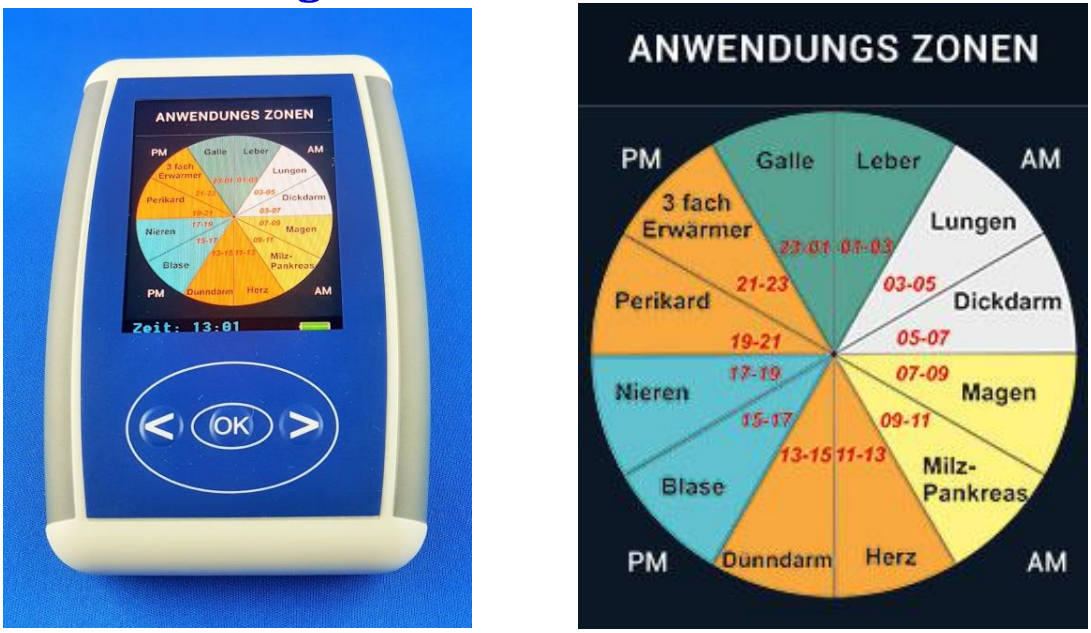

(Abb. 30)

Dabei erscheint eine Übersichtsempfehlung, welche den laut TCM bekannten Bio-Rhythmus der Körperorgane symbolisiert (siehe Abb. 30).

Symbolerklärung: „PM“ – Nachmittag; „AM“ - Vormittag

Zur Rückkehr in das Menü „Info“ bestätigen Sie mit „OK“-Taste und wählen das nächste Thema mit der „Rechtspfeil“-Taste aus.

11.2 Akkupunktur Punkte

Zur Bestätigung der „Akkupunkturpunkte“ drücken Sie die „OK“-Taste und Sie bekommen 14 Meridiane zur Auswahl. Mit den Pfeil-Tasten (rechts und links) bewegen Sie sich zu den einzelnen Meridianen.

Sie können die gewünschten Meridiane auswählen und mit der „OK“-Taste bestätigen.

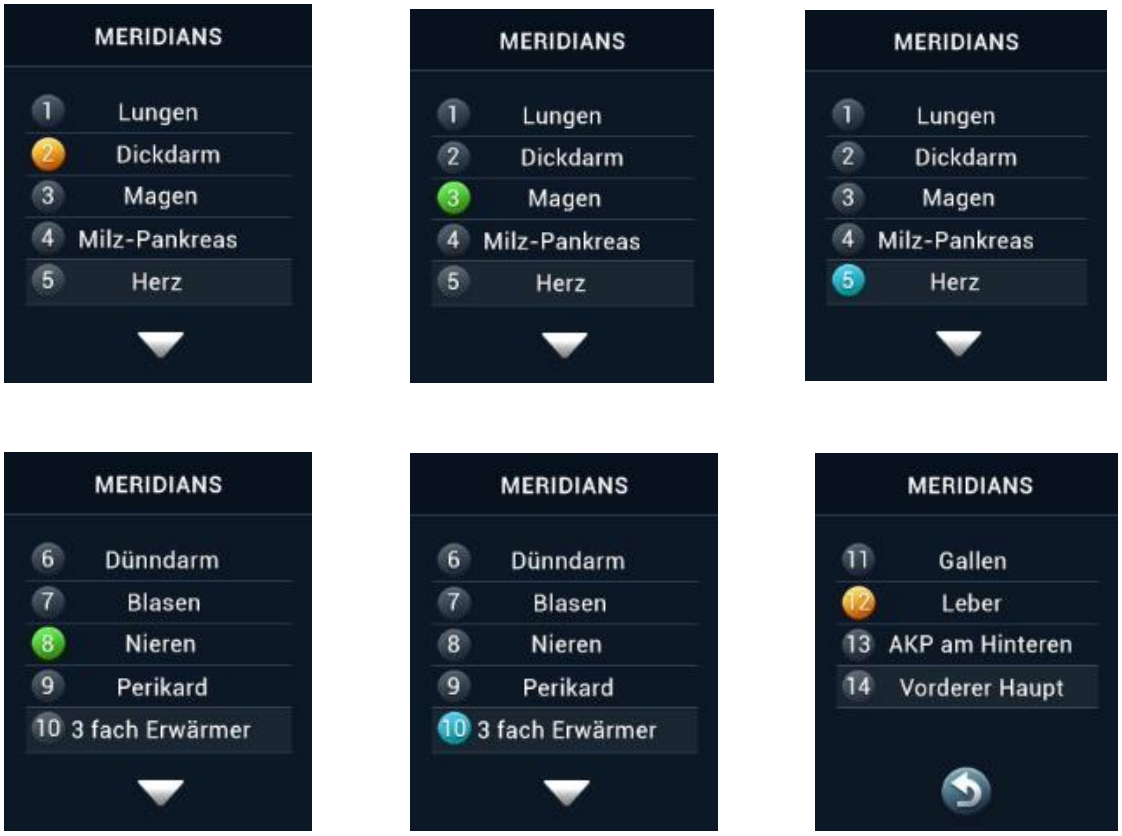

(Abb. 31)

Nach Auswahl des gewünschten Meridians erscheint das Akkupunktur-Bild für Ihre ausgewählte Anwendung (siehe Abb. 31).

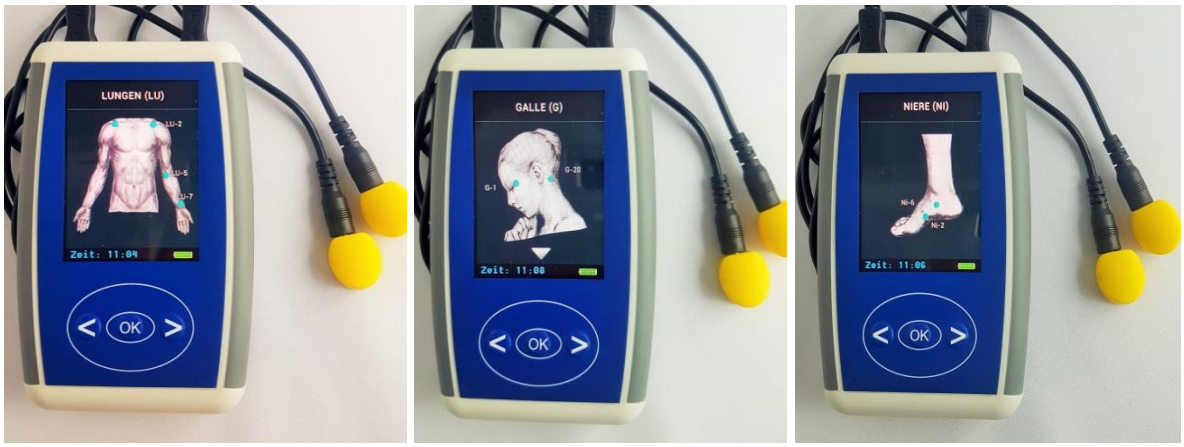

(Abb. 32)

Wählen Sie endsprechende Farbe vom Kristall Emitter und positionieren Sie diese mit der weißen, aktiven Seite mittels Pflaster auf die gewählte Stelle – am besten auf die rechte und linke Seite gleichzeitig - und starten das Programm mit Bestätigung der „OK"-Taste.

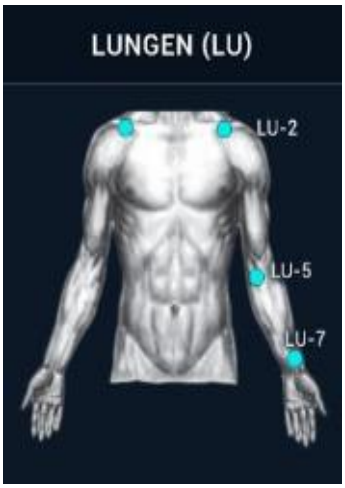

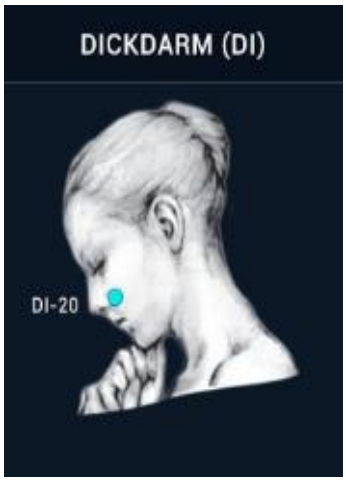

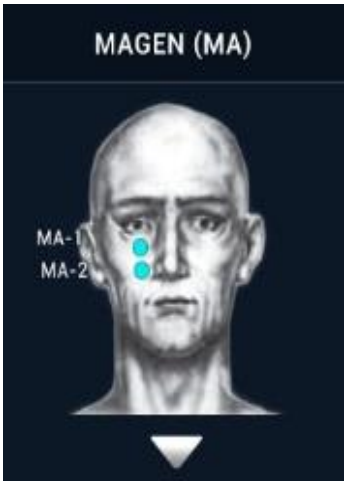

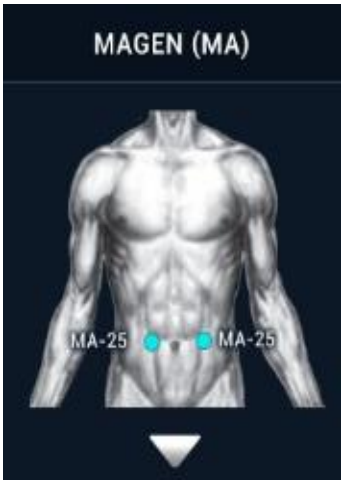

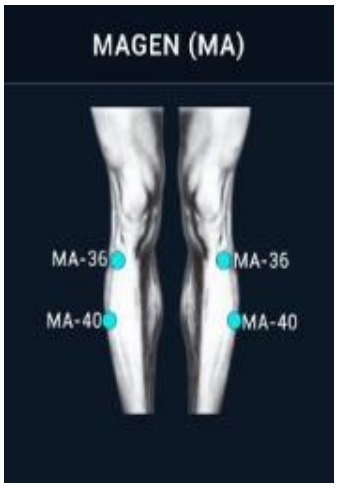

MILZ-PANKREAS (MiPa)
MiPa-6
MiPa-4

HERZ (HE)
He-3
He-5
He-7

DÜNNDARM (DÜ)
Dü-3
Dü-4

BLASE (BL)
BL-1
BL-2

BLASE (BL)
BL-60
BL-62

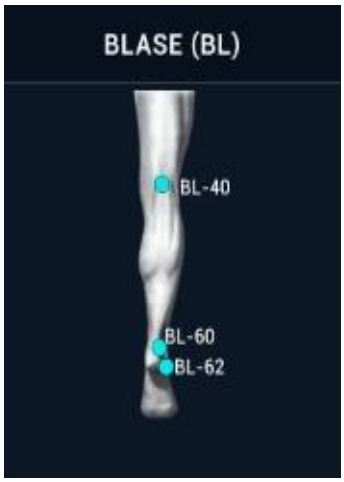
BLASE (BL)
BL-40
BL-60
BL-62

NIEREN (NI)
Ni-6
Ni-2

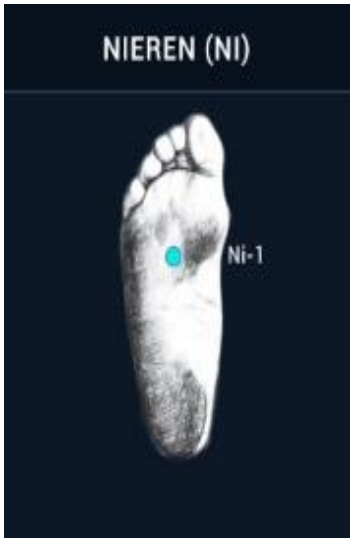
NIEREN (NI)
Ni-1

PERIKARD(PE)
PE-8
PE-9

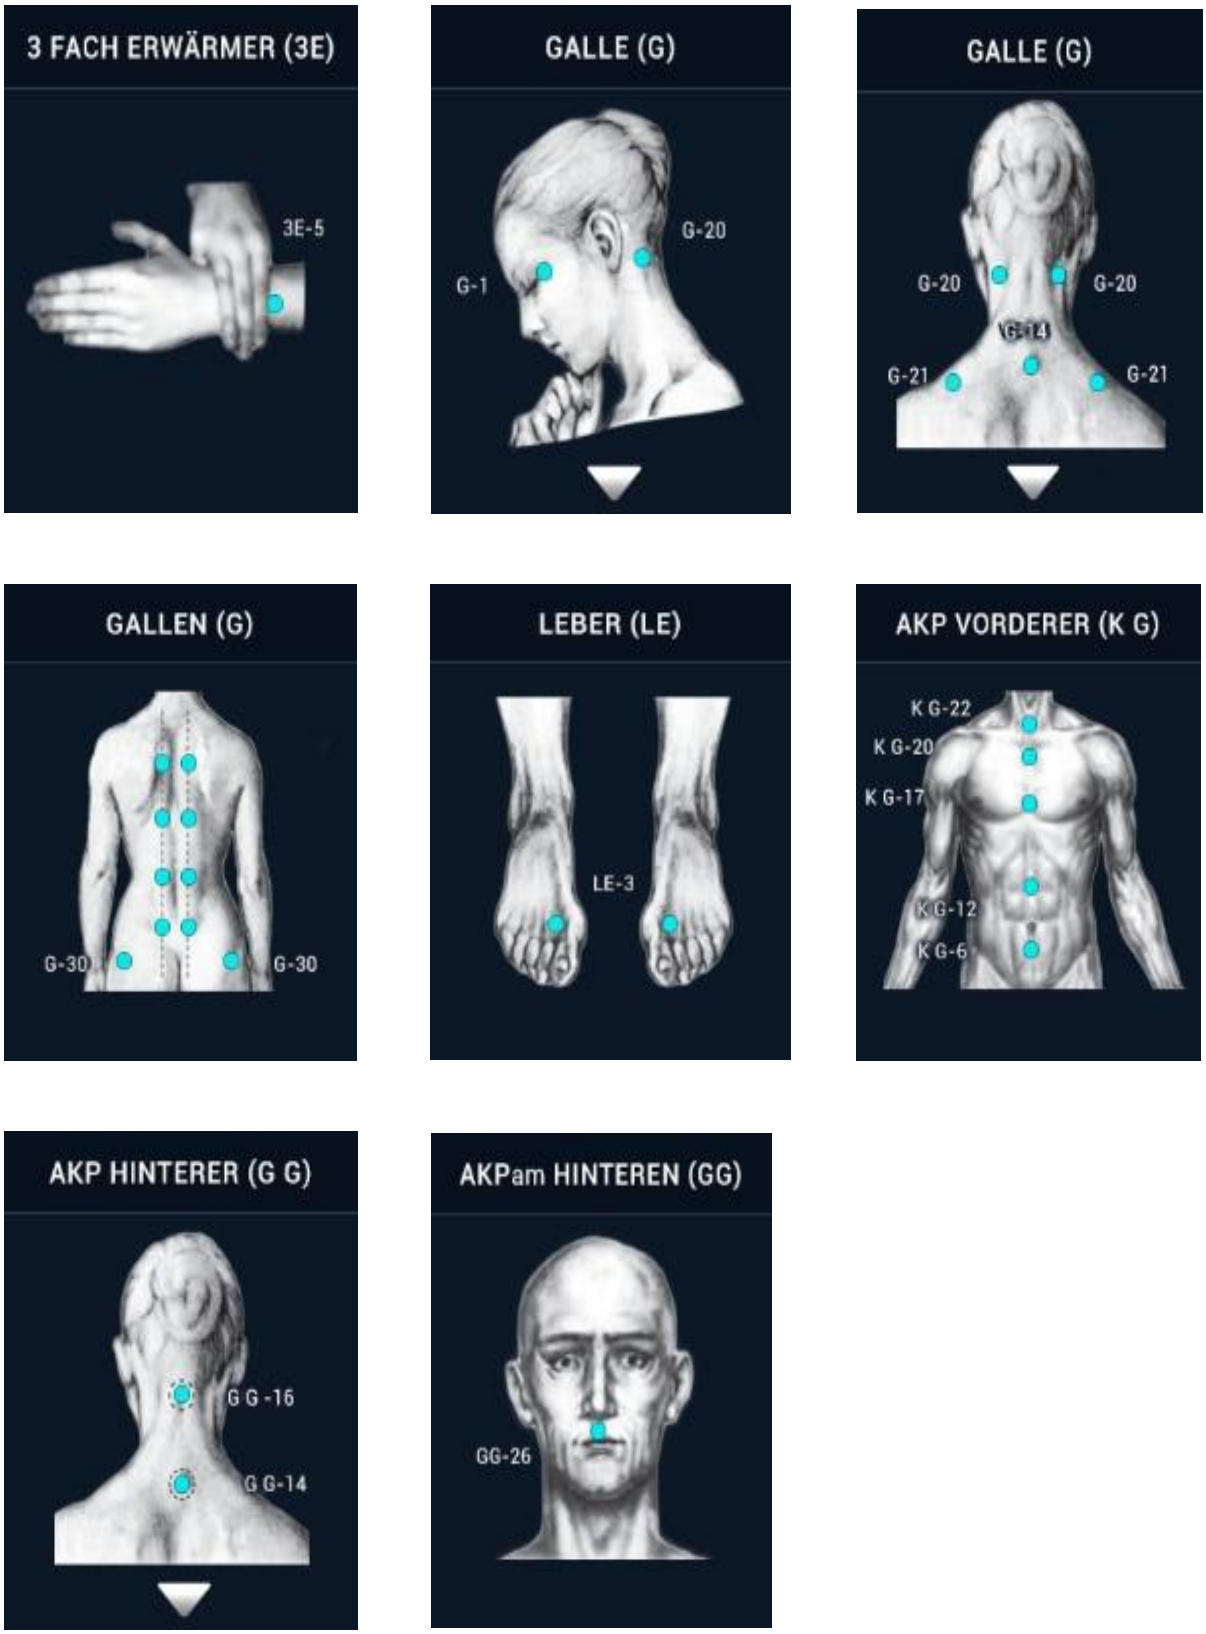

(Abb. 33)

Mit der „Rechtspfeil"-Taste können Sie die einzelnen Bilder bis zum Rückpfeil navigieren. Erscheint der Rückpfeil ROT, kommen Sie mit Bestätigung der „OK"-Taste wieder zurück ins darüber liegende Menü.

11.3 Anti- Stress Anwendung

(Abb. 34)

Die „Antistress“ Anwendung normalisiert Frequenzen unseres Körpers, welche das Blut mit Sauerstoff anreichern und dadurch wird unser Körper für weitere Anwendungen besser vorbereitet.

Dazu positionieren Sie den Kristall Emitter auf der Mitte der Unterarm-Innenseite, 3 fingerbreit neben der Beugefalte einer Hand (Abb. 34).

Empfehlung: Wenden Sie dieses Programm, abhängig vom Stressfaktor, bis zu dreimal täglich an.

12. Anwendung des Gerätes im täglichen Leben

Es wird empfohlen

In der Früh: 2 L Wasser strukturieren und Tags über schluckweise trinken.

Programm 1 mit gelbem oder rotem Kristall auf die Pulsader anwenden.

Während des Tages: Anti-Stress Anwendung.

Wenden Sie dieses Programm, abhängig vom Stressfaktor, bis zu dreimal täglich an.

Am Abend: Programm 2 mit blauem Kristall auf die Beruhigungspunkte (Alfa Punkte am Kopf und erste Wirbel Punkt im Nacken) anzuwenden.

Gesamte Tages Anwendungszeit sollte 1 Stunde nicht überschreiten!

13. Fazit

IQ-Well Gerät ALPHA ist Quelle einer neuen Lebensenergie, schützt Ihren Körper vor den schädlichen Einflüssen, hebt die inneren Ressourcen des Körpers und beschleunigt Ihre Fähigkeit zur Regeneration.

Die Anwendungen werden empfohlen als Begleitende Unterstützung der Basis -Therapie.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Gerät.

Aus rechtlichen Gründen geben wir folgenden Hinweis: In Europa sind MMW Geräte von der Schulmedizin nicht anerkannt. Zahlreiche medizinische Studien in russischen Uni-Kliniken zeigen allerdings erstaunliche Ergebnisse. Viele Anwender in Europa gehen diesen Alternativen Weg.

Teil II

IQ-WELL Alpha

Technisches Datenblatt

Inhaltsverzeichnis 32

1. Einführung 33

2. Einsatzbereich 33

3. Tabelle- Technische Daten 33

4. Lieferumfang 34

5. Beschriftung der Verpackung 35

6. Entsorgung 35

7. Technische Wartung 35

8. Betriebseinschränkungen 35

9. Transport und Lagerung 36

10. Mögliche Störungen 36

11. Garantie 37

12. Reklamationsschein 38

1. Einführung

Der Technische Pass ist ein vom Hersteller ausgestelltes Dokument, welches die Technischen Daten des Gerätes IQ-Well Alpha bestätigt.

2. Einsatzbereich

Das IQ - Well Alpha Gerät harmonisiert und aktiviert bei allen Lebewesen die Bio,- und Energie Systeme die über einen hohen Wasseranteil verfügen.
Es ist vielseitig einsetzbar bei Menschen, Tieren und Pflanzen.

3. Tabelle -Technische Daten

Gesamtabmessungen (H-B-T)	**117-79-24 mm**
Gewicht	**105 g**
Material	**ABS Kunsststoff**
Opt. Lagertemperatur **bei relativer Luftfeuchtigkeit**	**+5 C bis +35 C** **bis 80 % bei 25° C**
Interne Stromversorgung	**3,6 + 0,6 / -0,9 V**
• **Drahtloses Ladegerät** ***Eingang*** ***Frequenz*** ***Durchmesser*** ***NW***	**DC5V,2A** **110 - 205 KHz** **88mm** **55g**
Akku	**Polymer Li-Ion**
Betriebsbereich der Frequenzen	**40 - 78 GHz**
Anlaufzeit	**nicht mehr als 2 Sec.**
Automatische Abschaltfunktion	**60 Sekunden**
Betriebstemperatur	**zwischen + 10° und + 35°C**

4. Lieferumfang

Das Gerät IQ-WELL Alpha und Zubehör.

	Gerät IQ- WELL ALPHA	1
	Kristall-Emitter gelb Kristall-Emitter rot, blau, grün (je 1Stück)	2 3
	Kabel für Kristall-Emitter	2
	Ladegerät (3 Teile: Platte, USB Kabel (Netzstecker)	1

Pflege des Gerätes

Das Gerät und die Kristall Emitter können nur mittels Watte oder Tuch aus Baumwolle desinfiziert werden, leicht benetzt mit Alkohol oder einer spezieller Desinfektionslösung, die nicht den Kunststoff angreift.

5. Beschriftung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen. Die Verpackung enthält sämtliche Produkt- und Herstellerinformationen und ist mit den erforderlichen Sicherheitskennzeichen versehen.

- Name des Gerätes
- Hersteller
- CE Zeichen
- EU Normen
- Piktogramme

6. Entsorgung

Das Gerät wurde den EU Normen entsprechend hergestellt und ist an speziellen Entsorgungsstellen für Radioelektronik zu entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batteriesammelstation im Fachhandel!

7. Technische Wartung

Während der gesamten Lebensdauer des Gerätes sind keine technischen Wartungsarbeiten vorgesehen.

Es besteht die Möglichkeit das Gerät überprüfen zu lassen. Wenden Sie sich dabei an unsere Firma IQ-Well.

8. Betriebseinschränkungen

Es wird empfohlen, das Gerät erst zu verwenden, nachdem die technische Beschreibung gelesen wurde.

Das Gerät keinen übermäßigen mechanischen Vibrationen oder Stößen aussetzen.

Verwenden sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Ladegeräte.

Das Gerät darf keiner hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden und weder mit Flüssigkeiten, noch mit chemischen Substanzen in Berührung kommen.

Das Gerät und vor allem dessen Kleinteile für Kinder und Tiere unzugänglich aufbewahren. Es besteht Schluck- und Erstickungsgefahr

9. Transport und Lagerung

Das Gerät sollte in einem Transportbehälter in geschlossenen Fahrzeugen transportiert werden. Die Transport- und Lagerbedingungen müssen den Normen, im Sinne der Auswirkungen der klimatischen Faktoren, entsprechen.

Das Gerät ist in der Verpackung des Herstellers und in Lagerräumen im Sinne der Auswirkungen der klimatischen Faktoren

10. Mögliche Störungen

Am oberen Rand des Displays erscheint (zum jeweiligen Kabelanschluss) ein grünes Fenster, welches die Betriebsbereitschaft („ON“) signalisiert.

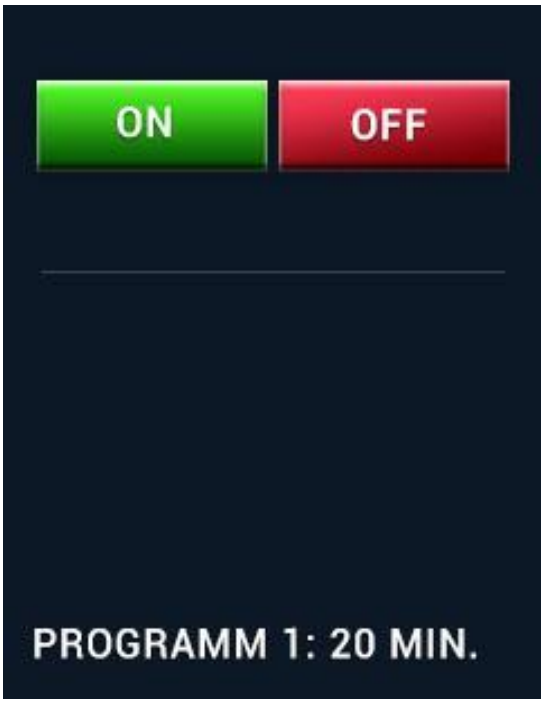

Leuchtet diese Rot mit „OFF“-Anschrift, weist dies darauf hin, dass ein Kabel oder Kristall Emitter nicht vollständig eingesteckt oder fehlerhaft ist.

Reparaturen dürfen nur vom Hersteller vorgenommen werden. Das Gerät ist ein elektronisches Gerät. **Stürze und Schläge sind zu vermeiden**, da diese zu Beschädigungen des Gerätes oder dessen Bestandteilen führen kann.

Bei Funktionsausfall des Gerätes sind keine Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Wenden Sie sich an den Verkäufer.

11. Garantie

- Für sämtliche Herstellungsfehler des Gerätes beträgt die Garantiefrist 12 Monate, ab dem nachgewiesenen Kauf- bzw. Lieferdatum.
- Bei Ausfall des Gerätes innerhalb der Garantiezeit erfolgt die Reparatur durch den Hersteller. Erfolgt der Ausfall als Folge des unsachgemäßen Betriebes, sind die Kosten für etwaige Reparaturen vom Verbraucher zu tragen.
- Wenn die Hologramm-Schutzfolie beschädigt oder zerstört wird, werden vom Hersteller keine Reklamationen hinsichtlich der Qualität des Gerätes angenommen und der Garantie-Service wird nicht durchgeführt.
- Reparaturarbeiten werden vom Hersteller des Gerätes auf Kosten des Verbrauchers in folgenden Fällen durchgeführt:

  Bei Beschädigung oder Zerstörung der Hologramm-Schutzfolie

  Beim Ausfall nach der Garantiezeit

Für Mängel, die durch unsachgemäße Lagerung oder nachlässige Anwendung des Produktes, von Seiten des Verbrauchers verursacht wurden, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

IQ-WELL HANDELSAGENTUR & HANDEL mit MEDIZINPRODUKTEN e.U.

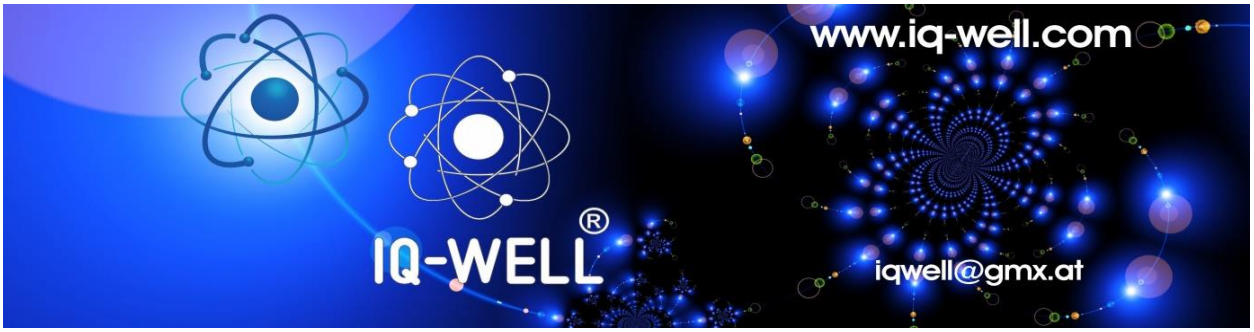

12. Reklamation Alle Reklamationen müssen vom Verkäufer registriert werde

Reklamationsnummer

Reklamationsschein für „IQ-WELL“ Produkte

Bitte alle Formularfelder vollständig ausfüllen und zusammen mit der Rechnungskopie beifügen!

Kunden- Nr.
Vor- und Nachname /Firma
Adresse
E-Mail Telefonnummer
Rechnungs-Nr.
Rechnungsdatum
Lieferdatum

Folgende Artikel werden vollständig und originalverpackt zurückgesandet.

Menge	**Gerät –Nr.**	**Artikel-Bezeichnung**
1.		
2.		
3.		
Fehlerbeschreibung:		

Ihr Wunsch: **Unterschrift:**